

Manual pentru
utilizator

Română

Dezinfectanți și soluții de curățare pentru sisteme cu ultrasunete și transductoare

PHILIPS

Cuprins

1	Cuvânt înainte	5
	Comentariile clientului	7
	Serviciul de relații cu clienții.....	8
	Convenții din informațiile pentru utilizator	8
2	Siguranță	11
	Avertismente și atenționări	11
	Expunerea la glutaraldehidă	15
3	Dezinfectanți și soluții de curățare.....	17
	Dezinfectanți și agenți de curățare pentru suprafețele sistemului.....	17
	Îndrumări pentru AR (Reprocesoare automate)	20
	Îndrumări pentru Dezinfecție pentru transductoarele TEE și Dezinfecție și curățătoare automate....	24
	Compatibilitatea cu transductoarele a dezinfecților și soluțiilor de curățare	27
	Compatibilitatea dezinfectorului în funcție de numele transductorului	28
	Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectorului	33
	Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile	38

Cuprins

3000 131 85551_A/795 * MAR. 2024

Philips

1 Cuvânt înainte

Informațiile pentru utilizator ale produsului Philips descriu cea mai complexă configurație a produsului, cu numărul maxim de opțiuni și accesori. Este posibil ca unele funcții descrise să nu fie disponibile în cadrul configurației produsului dumneavoastră.

Transductoarele sunt disponibile numai în țările sau regiunile în care sunt aprobate. Pentru informații specifice referitoare la regiunea dvs., contactați reprezentanța locală Philips.

Acest manual listează dezinfectanții și soluțiile de curățare compatibile cu transductoarele și sistemul dvs. cu ultrasunete Philips.

Informațiile din acest manual se aplică următoarelor sisteme cu ultrasunete:

- 5000 Compact series
- Seria Affiniti
- Seria ClearVue
- CX30
- CX50
- Seria EPIQ
- HD5
- HD6
- HD7
- Seria HD11
- HD15
- iE33
- iU22
- Lumify
- Sparq
- Xperius (distribuit de B. Braun)

Pentru informații referitoare la transductoarele sau sistemele cu ultrasunete Philips nespecificate în acest document, consultați documentele pentru utilizator ale sistemului, care conțin informații specifice pentru sistemul dvs. și transductoare.

Atunci când utilizați soluții de curățare și dezinfecțante, urmați întotdeauna cu strictețe instrucțiunile producătorului.

Datorită numărului mare de produse de curățare și dezinfecțare disponibile, este imposibil să alcătuim o listă cvasi-completă. Dacă nu sunteți sigur de posibilitatea utilizării unui anumit produs, contactați reprezentanța locală Philips pentru asistență.

Pentru instrucțiuni despre curățarea și dezinfecțarea sistemelor cu ultrasunete și transductoarelor, consultați *Îngrijirea și curățarea sistemelor cu ultrasunete și transductoarelor* (disponibilă cu documentația sistemului) sau site-ul web „Philips Ultrasound Care and Cleaning”:

www.philips.com/transducercare

Pentru o listă cu transductoarele compatibile cu sistemul dvs., consultați *Manualul pentru utilizator și Actualizarea informațiilor pentru utilizator* ale sistemului (dacă este cazul), care conțin informații specifice pentru sistem și transductoare.

Pentru mai multe informații:

- În America de Nord, contactați Philips la 800-722-9377.
- În afara Americii de Nord, vă rugăm contactați reprezentanța locală Philips.
- Vizitați website-ul „Philips Ultrasound Care and Cleaning”:

www.philips.com/transducercare

Acest document sau textele digitale și informațiile conținute în acesta sunt informații confidențiale, aflate în proprietatea Philips și nu vor fi reproduse, copiate în întregime sau parțial, adaptate, modificate, divulgăte altora sau răspândite fără prealabilă permisiune scrisă a departamentului juridic Philips. Acest document sau textele digitale sunt destinate utilizării fie de către clienți, fiind licențiat acestora ca parte a echipamentului Philips achiziționat de ei, fie pentru a răspunde reglementărilor precizate de FDA prin 21 CFR 1020.30 (și orice eventuale amendamente) sau oricărora alte reglementări locale. Utilizarea acestui document de către persoane neautorizate este strict interzisă.

Philips furnizează acest document fără vreun tip de garanție, implicită sau exprimată, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicate de comercializare și de adevarare pentru un scop anume.

Philips a luat măsuri pentru a asigura corectitudinea acestui document. Totuși, Philips nu își asumă responsabilitatea pentru erori sau omisiuni și își rezervă dreptul de a efectua fără aviz modificări asupra oricărui produs prezentat aici, cu scopul de a îmbunătăți fiabilitatea, funcționarea și aspectul. Philips poate aduce oricând îmbunătățiri sau modificări produselor sau programelor descrise în acest document.

Philips nu emite nicio delegație sau garanție utilizatorului și niciunei terțe părți în ceea ce privește adresabilitatea acestui document pentru un anumit scop sau în ceea ce privește capacitatea să de a obține un anumit rezultat. Dreptul utilizatorului de a recupera daunele cauzate din vina sau neglijența companiei Philips va fi limitat la suma plătită de utilizator către Philips pentru procurarea acestui document. În niciun caz compania Philips nu va fi responsabilă pentru daune, pierderi, costuri, cheltuieli, revendicări, cereri speciale, colaterale, țolidentale, directe, indirekte sau consecutive sau revendicări pentru profituri, date sau cheltuieli pierdute, de orice natură sau de orice fel.

Copierea neautorizată a acestui document nu numai că încalcă drepturile prevăzute prin copyright, dar poate reduce capacitatea companiei Philips de a pune la dispoziția utilizatorilor informații exacte și recente.

„Affiniti”, „Affiniti CVx”, „EPIQ”, „EPIQ CVx”, „EPIQ CVxi”, „iE33”, „iU22”, „Lumify”, „Sparq” și „xMATRIX” sunt mărci comerciale ale Koninklijke Philips N.V.

„Xperius” este o marcă comercială aflată în coproprietate între Koninklijke Philips N.V. și B. Braun Melsungen AG.

Numele de produse care nu aparțin Philips pot fi mărci comerciale ale proprietarilor acestora.

Comentariile clientului

Dacă aveți întrebări referitoare la informațiile pentru utilizator sau dacă descoperiți o eroare în această documentație, în S.U.A. contactați Philips la numărul de telefon 800-722-9377; în afara S.U.A., contactați serviciul de relații cu clienții al reprezentanței locale. De asemenea, puteți trimite un e-mail la următoarea adresă:

techcomm.ultrasound@philips.com

Serviciul de relații cu clienții

Reprezentanții serviciului de relații cu clienții sunt disponibili pe întreg globul pentru a vă răspunde la întrebări și pentru a asigura întreținerea și service-ul. Contactați reprezentanța locală Philips pentru asistență. Puteți, de asemenea, contacta biroul următor pentru a fi îndrumat către un reprezentant al serviciului de relații cu clienții, sau puteți vizita site-ul web „Contact Us”:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA
800-722-9377

Portalul de servicii pentru clienți Philips oferă o platformă online care vă ajută să vă gestionați produsele și serviciile Philips prin toate modalitățile:

<https://www.philips.com/customer-services-portal>

3000 131 85551_A/795 * MAR. 2024

Convenții din informațiile pentru utilizator

Informațiile pentru utilizator ale produsului dumneavoastră utilizează, de asemenea, convenții tipografice pentru a vă ajuta la găsirea și înțelegerea informațiilor:

- Toate procedurile sunt marcate cu un număr și toate subprocedurile cu o literă. Pentru a asigura succesul operațiunii trebuie să efectuați pași necesari în ordinea prezentată.
- Listele punctate prezintă informații generale despre o anumită funcție sau procedură. Acestea nu implică o procedură secvențială.

- Partea stângă a sistemului este la stânga dumneavoastră când stați în fața sistemului, cu fața la sistem. Partea din față a sistemului este cea mai aproape de dumneavoastră, în timp ce îl utilizați.
- Transductoarele și sondele-creion sunt asimilate amândouă noțiunii de transductor, cu excepția cazului când distincția este importantă pentru înțelesul textului.

Informațiile esențiale pentru utilizarea sigură și eficientă a produsului apar pe tot parcursul informațiilor pentru utilizator după cum urmează:



AVERTISMENT

Avertismentele evidențiază informații vitale pentru siguranța dumneavoastră ca operator și a pacientului.



ATENȚIE

Atenționările subliniază moduri în care ați putea deteriora produsul, anulând astfel garanția sau contractul de service, sau moduri în care puteți pierde date ale pacientului sau sistemului.

OBSERVAȚIE

Observațiile vă atenționează asupra unor informații importante care vă vor ajuta să utilizați mai eficient produsul.

2 Siguranță

Citiți informațiile incluse în această secțiune pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor care operează și întrețin echipamentul cu ultrasunete, a tuturor pacienților care participă la examinări, și pentru a asigura calitatea sistemului și a accesoriilor sale.

Avertismente și atenționări

Pentru o siguranță maximă la utilizarea agenților de curățare și dezinfecțanților, respectați următoarele avertismente și precauții:



AVERTISMENT

Nu toți dezinfecțanții sunt eficace asupra tuturor tipurilor de contaminare. Asigurați-vă că tipul dezinfecțantului este corespunzător sistemului sau transductorului specificat și că durata contactului și concentrația soluției sunt corespunzătoare pentru uzul clinic preconizat.



AVERTISMENT

Dezinfecțanții sunt recomandați datorită compatibilității lor chimice cu materialele produsului și nu pentru eficacitatea lor biologică. Pentru eficacitatea biologică a unui dezinfecțant, vă rugăm să consultați recomandările și instrucțiunile producătorului de dezinfecțanți, ale Administrației alimentelor și medicamentelor a S.U.A. și ale Centrelor pentru controlul bolilor din S.U.A.



AVERTISMENT

Dacă se utilizează o soluție preparată anterior, respectați data expirării.

**AVERTISMENT**

Nivelul de dezinfectare necesar unui dispozitiv depinde de tipul de țesut cu care acesta vine în contact în timpul utilizării și de tipul de transductor utilizat. Asigurați-vă că tipul de dezinfectant este corespunzător tipului transductorului și aplicației pentru care acesta este utilizat. Pentru mai multe informații despre cerințele de dezinfecție necesare, consultați *Îngrijirea și curățarea sistemelor cu ultrasunete și a transductoarelor*. De asemenea, consultați instrucțiunile de pe eticheta dezinfectantului și recomandările Asociației Specialiștilor în Controlul Infecțiilor, ale Administrației Alimentelor și Medicamentelor S.U.A. și AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine) Official Statements. „Guidelines for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel” și ale Centrelor pentru controlul bolilor din S.U.A.

**AVERTISMENT**

Urmați recomandările producătorului agenților de curățare sau ale dezinfectantului.

**AVERTISMENT**

La curățarea, dezinfectarea sau sterilizarea oricărui tip de echipament, utilizați întotdeauna ochelari și mănuși de protecție.

**ATENȚIE**

Utilizarea dezinfectanții recomandați, a concentrațiilor incorecte sau înmuierea mai adâncă sau pentru mai multă vreme a transductorului poate deteriora sau decolora transductorul și va duce la anularea garanției acestuia.



ATENȚIE

Utilizarea pe transductoare a alcoolului izopropilic (alcool medicinal), a alcoolului etilic denaturat și a altor produse pe bază de alcool este limitată. În cazul transductoarelor cu conector USB, singurele părți ce pot fi șterse cu alcool sunt: carcasa și lentilele transductorului (fereastră acustică). În cazul transductoarelor non-TEE, singurele părți ce pot fi șterse cu alcool sunt: carcasa conectorului și carcasa și lentilele transductorului. În cazul transductoarelor TEE, singurele părți ce pot fi șterse cu alcool sunt carcasa conectorului și carcasa de comandă. Asigurați-vă că soluția este de 91% alcool izopropilic sau mai slabă sau de 85% de alcool etilic denaturat sau mai slabă. Nu ștergeți nicio altă parte a unui transductor cu alcool (inclusiv cablurile, conectorii USB sau manșoanele de detensionare), deoarece componentele respective ale transductorului se pot deteriora. Aceste deteriorări nu sunt acoperite de garanție sau de contractul dvs. de service.



ATENȚIE

Unele produse de curățare sau de dezinfecțare pot determina decolorări dacă dezinfecțantul și gelul rezidual nu au fost îndepărtate complet după fiecare utilizare. Întotdeauna îndepărtați gelul în totalitate înainte de a utiliza agenți de curățare și dezinfecțanți. Dacă este nevoie, acolo unde există compatibilitate de utilizare, puteți folosi alcool izopropilic 70% pentru eliminarea acumulării de reziduuri pe componentele sistemului. Dacă este nevoie, acolo unde există compatibilitate de utilizare, puteți folosi soluții de alcool izopropilic 91% sau mai slabe sau soluții de alcool etilic denaturat 85% sau mai slabe pentru eliminarea acumulării de reziduuri pe sistem și componente transductorului.



ATENȚIE

Nu aplicați filme adezive, precum Tegaderm, pe lentilele transductorului. Aceste filme ar putea deteriora lentilele.

**ATENȚIE**

Pentru ecranele monitoarelor, nu utilizați agenți de curățare pentru geamuri, sprayuri de curățare sau produse care conțin înălbitor. Utilizarea repetată a unor astfel de agenți sau produse de curățare poate deteriora suprafața ecranului monitorului. Pentru a preveni acumularea de reziduuri, ștergeți imediat substanțele dezinfecțante sau de curățare aprobate. Utilizați agenți de curățare speciali pentru curățarea ecranelor LCD sau OLED.

**ATENȚIE**

Pentru ecranul tactil, nu utilizați sprayuri de curățare sau produse care conțin înălbitor sau alcool. Utilizarea repetată a unor astfel de agenți sau produse de curățare poate deteriora suprafața ecranului tactil. Pentru a preveni acumularea de reziduuri, ștergeți imediat substanțele dezinfecțante sau de curățare aprobate.

**ATENȚIE**

Utilizarea capacului de protecție pentru pinii conectorului pentru transductoarele TEE în timpul proceselor de decontaminare este obligatorie. Pentru a utiliza transductorul pentru scanare, îndepărtați capacul de pe conector. Păstrați întotdeauna capacul prinț de cablul transductorului cu cureaua.

**ATENȚIE**

Când înmuiați un transductor în lichid, asigurați-vă întotdeauna că nu există bule de aer vizibile pe transductor. Bulele de aer preven contactul complet dintre soluție și transductor și pot împiedica procesele de curățare, dezinfecțare sau sterilizare.

Expunerea la glutaraldehidă

Administrația pentru siguranța ocupațională și sănătate din Statele Unite (OSHA) a emis o reglementare asupra nivelurilor acceptabile de expunere la glutaraldehidă în mediul de lucru. Philips nu comercializează dezinfectanți pe bază de glutaraldehidă în cadrul produselor sale.

Pentru a reduce prezența vaporilor de glutaraldehidă în aer utilizați un bazin de înmuiere acoperit sau ventilat. Asemenea sisteme sunt disponibile pe piață. Cele mai recente informații despre astfel de produse pot fi găsite pe website-ul „Philips Ultrasound Care and Cleaning” al Philips:

www.philips.com/transducercare

3 Dezinfectanți și soluții de curățare

Următoarele subiecte listează dezinfecții și soluțiile de curățare compatibile cu transductoarele și sistemul dvs. cu ultrasunete Philips.

Dezinfectanți și agenți de curățare pentru suprafețele sistemului

Sisteme Lumify

Utilizatorului îi revine responsabilitatea curățării și dezinfecției adecvate a dispozitivului, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului dispozitivului și cu politica instituției dvs. referitoare la curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale.

Pentru informații referitoare la curățarea componentelor Philips Lumify, consultați documentele pentru utilizator Lumify.



AVERTISMENT

Dacă dispozitivul mobil compatibil cu Lumify va fi contaminat intern cu lichide biologice purtătoare de patogeni, trebuie să anunțați imediat reprezentanța de service Philips. Componentele din interiorul dispozitivului nu pot fi dezinfecțiate. În acest caz, dispozitivul trebuie îndepărtat ca material periculos biologic, în conformitate cu reglementările locale sau naționale.

Celealte sisteme, cu excepția sistemelor Lumify

Compatibilitatea dezinfecților și agenților de curățare depinde de componenta pentru care sunt utilizați. Produsele din tabelul următor sunt compatibile cu următoarele suprafețe ale sistemului:

- Cablurile, derivațiile și electrozii ECG

- Suprafețele externe din plastic și vopsite ale sistemului și căruciorului
- Panoul de comandă al sistemului
- Ecranele monitoarelor și ecranele tactile
- Sisteme de gestionare a cablurilor transductoarelor cu cleme facile

Soluții de curățare pentru toate suprafețele	Soluții de curățare pentru ecranele monitoarelor și ecranele tactile	Dezinfectanți pentru suprafețele sistemului și ecranele tactile
Soluție slabă de săpun ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Soluție slabă de săpun¹ • Agenți de curățare speciali pentru ecranele LCD sau OLED • Apă purificată 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcool izopropilic 70% (AIP) (nu este aprobat pentru ecranele tactile) • Opti-Cide3 (pe bază de QUAT/IPA) • Oxivir Tb (pe bază de peroxid de hidrogen accelerat) • Spray-ul sau șervețele Protex sunt compatibile doar cu: <ul style="list-style-type: none"> – Sistemele din seria 5000 Compact – Sistemele din seria Affiniti – Sistemele din seria EPIQ – Sistemul Xperius • Sani-Cloth HB (pe bază de QUAT) • Sani-Cloth Plus (pe bază de QUAT/IPA) • PI-Spray II (pe bază de QUAT)

1. Soluțiile slabe de săpun nu conțin ingrediente dure și nu sunt iritante pentru piele. Acestea nu trebuie să conțină parfumuri, uleiuri sau alcool. Dezinfectanții pentru mâini nu sunt aprobați pentru utilizare.

**ATENȚIE**

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau acetonă, MEK (Methyl Ethyl Ketone), diluant de vopsea sau alți solventi puternici pe sistem, pe periferice sau pe transductoare.

**ATENȚIE**

Nu utilizați Sani-Cloth AF3 sau Super Sani-Cloth pentru dezinfectarea sistemului.

**ATENȚIE**

Nu vărsați sau pulverizați lichid în îmbinările sistemului, în porturile sau în mufele de conectare a transductoarelor.

**ATENȚIE**

Pentru ecranele monitoarelor sau ecranele tactile utilizați o lavetă din microfibre; nu utilizați șeruite de hârtie.

**ATENȚIE**

Pentru ecranele monitoarelor, nu utilizați agenți de curățare pentru geamuri, sprayuri de curățare sau produse care conțin înălbitor. Utilizarea repetată a unor astfel de agenți sau produse de curățare poate deteriora suprafața ecranului monitorului. Pentru a preveni acumularea de reziduuri, ștergeți imediat substanțele dezinfectante sau de curățare aprobate. Utilizați agenți de curățare speciali pentru curățarea ecranelor LCD sau OLED.

**ATENȚIE**

Pe ecranul tactil, nu utilizați sprayuri de curățare sau produse care conțin înălbitor sau alcool. Utilizarea repetată a unor astfel de agenți sau produse de curățare poate deteriora suprafața ecranului tactil. Pentru a preveni acumularea de reziduuri, ștergeți imediat substanțele dezinfecțante sau de curățare aprobate.

**ATENȚIE**

Suprafețele sistemului și transductoarele sunt rezistente la gelul de transmitere a ultrasunetelor, la alcool și dezinfecțanți dar, dacă utilizați aceste substanțe, trebuie să le ștergeți imediat pentru a preveni deteriorarea permanentă a suprafețelor.

Pentru instrucțiuni despre curățarea și dezinfecțarea sistemelor cu ultrasunete și transductoarelor, consultați *Îngrijirea și curățarea sistemelor cu ultrasunete și transductoarelor* sau website-ul „Philips Ultrasound Care and Cleaning”:

www.philips.com/transducercare

3000 131 85551_A/795 * MAR. 2024

Îndrumări pentru AR (Reprocesoare automate)

Numai anumite transductoare sunt compatibile cu reprocesoarele automate (AR), iar AR poate utiliza numai anumite soluții sau condiții de procesare.

Puteți reprocesa transductoarele Philips în AR cu condiția de a fi îndeplinite următoarele criterii:

- Toate substanțele chimice și condițiile de procesare utilizate trebuie să fie compatibile în mod special cu transductorul Philips specific ce este reprocesat, și trebuie utilizate în condițiile recomandate de fabricantul AR.
- Temperatura utilizată în timpul reprocesării nu trebuie să depășească 56 °C (133 °F).

- Cu excepția situației în care se utilizează sistemul STERRAD 100S, conectorul transductorului trebuie să fie izolat și să nu intre în contact cu soluția de curățare sau dezinfecție pe parcursul reprocesării. Astfel, riscul de stropire a mânerului sau conectorului este limitat.

Mai jos sunt enumerate exemple de AR care îndeplinesc cerințele de reprocesare ale transductoarelor Philips non-TEE specifice. Aceste AR fie sunt proiectate special pentru reprocesarea transductoarelor specifice, fie sunt prevăzute cu accesorii ce susțin transductoarele.

OBSERVAȚIE

În plus față de alte AR listate în tabelul următor, dacă un AR îndeplinește criteriile din lista precedentă este, de asemenea, aprobat pentru utilizare.

Exemple: AR compatibile cu transductoare pentru Philips non-TEE

Producător	Țara de origine	Model	Tip de transductor	Dezinfectanți sau metode compatibile	Condiții de procesare
Advanced Sterilization Products	US	STERRAD 100S	L10-4lap	Peroxid de hidrogen	50 °C (122 °F)

Producător	Țara de origine	Model	Tip de transductor	Dezinfectanți sau metode compatibile	Condiții de procesare
CIVCO Medical Solutions	US	Astra VR	Endocavity ¹	Cidex OPA, Revital-Ox RESERT, MetriCide OPA Plus, UltrOx	între 20 °C și 25 °C (între 68 °F și 77 °F)
		Astra VR Ultra	Endocavity ¹	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox RESERT, UltrOx	între 20 °C și 25 °C (între 68 °F și 77 °F)
CS Medical	US	Ethos Reprocessor	Multiple ²	Aquacide	47 °C (116.6 °F)
Germitec	FR	Antigermix S1	Multiple ³	UV-C	Temperatura ambientă
		Hypernova Chronos	Multiple ³	UV-C	Temperatura ambientă
Lumicare ONE	AU	Lumicare ONE	Multiple ⁴	UV-C	Temperatura ambientă
Medivators	US	ADVANTAGE PLUS (rețineți că trebuie să folosiți kitul optional de susținere pentru sonda ecografică)	Multiple ⁵	RAPICIDE PA Single Shot	30 °C (86 °F)
Nanosonics	AU	Trophon EPR trophon2	Multiple ⁶	Peroxid de hidrogen	56 °C (133 °F)

1. Pentru transductoarele compatibile transvaginale și transrectale, consultați Astra VR sau Astra VR Ultra din „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)” de la pagina 38 și utilizați apoi numărul din coloana Compatibilitate pentru a deschide lista adecvată în „[Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului](#)” de la pagina 33.
2. Pentru transductoarele compatibile, consultați Aquacide utilizat în Ethos Reprocessor din „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)” de la pagina 38 și utilizați apoi numărul din coloana Compatibilitate pentru a deschide lista adecvată în „[Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului](#)” de la pagina 33.
3. Pentru transductoarele compatibile, consultați Antigermix S1 sau Hypernova Chronos din „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)” de la pagina 38 și utilizați apoi numărul din coloana Compatibilitate pentru a deschide lista adecvată în „[Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului](#)” de la pagina 33.
4. Pentru transductoarele compatibile, consultați Lumicare ONE din „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)” de la pagina 38 și utilizați apoi numărul din coloana Compatibilitate pentru a deschide lista adecvată în „[Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului](#)” de la pagina 33.
5. Pentru transductoarele compatibile, consultați Advantage Plus (rețineți că trebuie să folosiți kitul optional de susținere pentru sonda ecografică) din „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)” de la pagina 38 și utilizați apoi numărul din coloana Compatibilitate pentru a deschide lista adecvată în „[Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului](#)” de la pagina 33.
6. Pentru transductoarele compatibile, consultați trophon EPR și trophon2 din „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)” de la pagina 38 și utilizați apoi numărul din coloana Compatibilitate pentru a deschide lista adecvată în „[Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului](#)” de la pagina 33.

Îndrumări pentru Dezinfectori pentru transductoarele TEE și Dezinfectori și curățătoare automate

Numai anumite transductoare sunt compatibile cu dezinfectorile automate pentru transductoarele TEE sau dezinfectori și curățătoare automate pentru transductoarele TEE, iar dispozitivele automate pot utiliza numai anumite soluții.

Puteți prelucra transductoarele TEE Philips în dezinfectorile automate pentru transductoarele TEE sau dezinfectori și curățătoare automate pentru transductoarele TEE numai dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

- Toate substanțele chimice și condițiile de procesare utilizate trebuie să fie compatibile în mod special cu transductorul TEE Philips specific ce este reprocesat, și trebuie utilizate în condițiile recomandate de fabricantul reprocesorului.
- Temperatura utilizată în timpul reprocesării nu trebuie să depășească 45 °C (113 °F).
- Mânerul și conectorul transductorului pentru TEE trebuie să fie izolat și să nu intre în contact cu soluția de curățare sau dezinfectare pe parcursul reprocesării, aici fiind incluse și suportul pentru mâner și mecanismele de sigilare. Astfel, riscul de stropire a mânerului sau conectorului este limitat.
- Este interzisă utilizarea barierelor protectoare sau a dispozitivelor destinate să izoleze mânerul și conectorul pentru a permite scufundarea completă a întregului transductor sau expunerea la soluție dezinfectantă în timpul reprocesorului.
- Este interzisă utilizarea metodelor de uscare prin căldură.

În tabelul de mai jos sunt enumerate exemple de reprocesoare care îndeplinesc cerințele de reprocesare pentru transductoarele pentru TEE Philips. Aceste reprocesoare fie sunt proiectate special pentru reprocesarea transductoarelor pentru TEE, fie sunt prevăzute cu accesorii ce susțin transductoarele.



ATENȚIE

Utilizarea capacului de protecție pentru pinii conectorului pentru transductoarele TEE în timpul proceselor de decontaminare este obligatorie. Pentru a utiliza transductorul pentru scanare, îndepărtați capacul de pe conector. Păstrați întotdeauna capacul prinț de cablul transductorului cu cureaua.

OBSERVAȚIE

Pe lângă reprocesoarele enumerate în tabelul următor, sunt aprobată pentru utilizare și alte dezinfectore automate pentru transductoarele TEE sau dezinfectore și curățătoare automate pentru transductoarele TEE care poartă însemnul FDA sau CE de aprobată pentru utilizare cu transductoarele pentru TEE și îndeplinește criteriile din lista precedentă.

Exemple: Reprocesoare compatibile cu transductoare pentru TEE Philips

Producător	Țara de origine	Model	Tip de transductor	Dezinfectanți sau metode compatibile	Condiții de procesare
CIVCO Medical Solutions	US	Astra TEE	TEE	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox, RESERT, UltrOx	între 20 °C și 25 °C (între 68 °F și 77 °F)
		Astra TEE Ultra	TEE	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox, RESERT, UltrOx	între 20 °C și 25 °C (între 68 °F și 77 °F)

Producător	Țara de origine	Model	Tip de transductor	Dezinfectanți sau metode compatibile	Condiții de procesare
CS Medical	US	Reprocesor TD-100	TEE	TD-5 HLD, TD-8 HLD	Între 38 °C și 40 °C (între 100,4 °F și 104 °F)
		Reprocesor TD-200	TEE	TD-12 HLD	38 °C (100,4 °F)
		Reprocesor TEEClean	TEE	TD-5 HLD, TD-8 HLD, TEEZyme Cleaner	Între 38 °C și 40 °C (între 100,4 °F și 104 °F)
Germitec	FR	Antigermix E1	TEE	UV-C	Temperatura ambiantă
Medivators	US	ADVANTAGE PLUS (rețineți că trebuie să folosiți kitul opțional de susținere pentru sonda TEE/TOE)	TEE	RAPICIDE PA Single Shot	30 °C (86 °F)
		DSD-201 (rețineți că trebuie să folosiți kitul opțional Bridge)	TEE	RAPICIDE Glut, RAPICIDE PA, RAPICIDE OPA/ 28	30 °C (86 °F)
		DSD EDGE (rețineți că trebuie să folosiți kitul opțional Bridge)	TEE	RAPICIDE PA Single Shot	30 °C (86 °F)
Soluscope	FR	Serie TEE	TEE	Soluscope P/ Soluscope A, Proxy P/Proxy A	40°C (104°F)

Pentru instrucțiuni despre curățarea și dezinfectarea transductoarelor pentru TEE, cu dezinfectori automate pentru transductoarele TEE sau dezinfectori și curățătoare automate pentru transductoarele TEE, consultați *Îngrijirea și curățarea sistemelor cu ultrasunete și transductoarelor*.

Compatibilitatea cu transductoarele a dezinfectanților și soluțiilor de curățare

Această secțiune include trei tabele care vă permit să identificați dezinfectantul și soluțiile de curățare disponibile pentru transductoarele dvs.

- „[Compatibilitatea dezinfectantului în funcție de numele transductorului](#)“ de la pagina 28: Listea transductoarele în ordine alfanumerică, cu referințe la compatibilitatea cu dezinfectanții și soluțiile de curățare corespunzătoare. Identificați transductorul în coloana Nume transductor și consultați referința Coloană compatibilitate pentru coloana Compatibilitate corespunzătoare a „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)“ de la pagina 38.
- „[Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului](#)“ de la pagina 33: Organizează transductoarele în funcție de coloana Compatibilitate corespunzătoare a „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)“ de la pagina 38. Utilizați acest tabel pentru a înțelege rapid ce transductoare corespund coloanelor de Compatibilitate numerotate.
- „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)“ de la pagina 38: Listea dezinfectanții și soluțiile de curățare compatibile cu transductoarele Philips. Coloanele de Compatibilitate numerotate indică compatibilitatea dezinfectanților și a soluțiilor de curățare cu transductoarele corespunzătoare. Utilizați oricare dintre cele două tabele cu transductoare pentru a determina ce coloană de Compatibilitate corespunde transductorului dvs.

Compatibilitatea dezinfectantului în funcție de numele transductorului

În acest tabel sunt prezentate transductoarele în ordine alfanumerică, cu referințe la compatibilitatea cu dezinfectanții și soluțiile de curățare corespunzătoare. Identificați transductorul (și sistemul, dacă este denumit) în coloana Nume transductor și consultați referința Coloană compatibilitate pentru a identifica coloana Compatibilitate corespunzătoare a „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)” de la pagina 38. Dacă un sistem nu este înregistrat, atunci toate versiunile transductorului utilizează aceeași coloană de Compatibilitate.

Pentru o listă a transductoarelor compatibile cu sistemul dvs., consultați *Manualul pentru utilizator* și *Actualizarea informațiilor pentru utilizator*, dacă este cazul.

Referințe de compatibilitate în funcție de numele transductorului

Nume transductor (nume sistem)	Coloana Compatibilitate
Creion CW 1,9MHz	3
TCD 1,9MHz	3
3D6-2	1
3D8-4	1
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	1
3D9-3v (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ)	2
Creion CW 5,0MHz	3
7,5 MHz Endo	1
BP10-5ec	2
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	1
C5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ, Sparq)	2
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	1
C5-2 (ClearVue)	2
C5-2 (Lumify, Xperius)	8

Nume transductor (nume sistem)	Coloana Compatibilitate
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	1
C6-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)	2
C6-3	1
C8-4v	1 sau 2 [†]
C8-5	1
C8-5 Compact (CX30, CX50)	1
C8-5 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	2
C9-2	2
C9-3io	7
C9-3v	2
C9-4	1
C9-4ec	1
C9-4v	2
C9-4v Compact	2
C9-5ec	1
C10-3v	2
C10-4ec	2
D2cwc	3
D2tcd	3
D5cwc	3
eL18-4	2
eL18-4 EMT	2

Nume transductor (nume sistem)	Coloana Compatibilitate
L8-4	1
L9-3	1
L10-4lap	6
L11-3	1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	1
L12-3 (5000 Compact, Affiniti, CX50, EPIQ)	2
L12-3ERGO	2
L12-4 (ClearVue)	2
L12-4 (Lumify, Xperius)	8
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	1
L12-4 Compact (5000 Compact, Affiniti)	2
L12-5 38 mm	1
L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq)	1
L12-5 50 mm Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	2
L12-5 50 mm	1
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22)	1 sau 2 ‡
L15-7io (5000 Compact, Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)	2
L17-5	1
L18-5	2
mC7-2	2
mC12-3	2
mL26-8	2

Nume transductor (nume sistem)	Coloana Compatibilitate
OMNI III TEE	5
S3-1	1
S4-1 (iU22)	1
S4-1 (ClearVue)	2
S4-1 (Lumify)	8
S4-2	1
S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)	1
S4-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)	2
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)	1
S5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	2
S5-2	1
S6-2mpt	5
S7-2t	5
S7-3t	4
S8	1
S8-3	1
S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)	1
S8-3 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	2
S8-3t	4
S9-2	2
S12	1
S12-4	1

Nume transductor (nume sistem)	Coloana Compatibilitate
S12-4 Compact (CX50)	1
S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
TCD	3
V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)	1
V6-2 (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)	2
V9-2	2
V8-4	1
VL13-5	1
VL13-5 Compact	2
X3-1	1
X5-1 (iE33)	1
X5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
X5-1c	2
X6-1	2
X7-2 (iE33, iU22)	1
X7-2 (EPIQ)	2
X7-2t	5
X8-2t	5
XL14-3	2

Note de subsol

†	<p>Utilizați coloana de Compatibilitate 2 pentru modelele C8-4v cu următoarele coduri pentru componente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cod componentă 45356117292x, unde x este 3 sau mai mare• Cod componentă 45356128750x, unde x este 2 sau mai mare• Cod componentă 45356131895x, unde x este 1 sau mai mare• Cod componentă 45356149748x, unde x este 1 sau mai mare• Cod componentă 45356149749x, unde x este 1 sau mai mare• Cod componentă 45356168452x, unde x este 1 sau mai mare <p>Utilizați coloana de Compatibilitate 1 pentru modelele C8-4v cu alte coduri pentru componente.</p> <p>Pentru a identifica codul pentru componentă, trebuie să vă uitați în interiorul carcasei conectorului.</p>
‡	<p>Utilizați coloana de Compatibilitate 2 pentru modelele L15-7io cu următoarele coduri pentru componente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cod componentă 45356140781x, unde x este 1 sau mai mare• Cod componentă 45356141827x, unde x este 1 sau mai mare <p>Utilizați coloana de Compatibilitate 1 pentru modelele L15-7io cu alte coduri pentru componente.</p> <p>Pentru a identifica codul pentru componentă, trebuie să vă uitați în interiorul carcasei conectorului.</p>

Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului

Acest tabel organizează transductoarele în funcție de coloana Compatibilitate corespunzătoare a „[Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile](#)” de la [pagina 38](#). De asemenea, și culorile anteturilor coloanelor corespund culorii coloanei Compatibilitate. Dacă un sistem nu este înregistrat, atunci toate versiunile transductorului utilizează aceeași coloană de Compatibilitate.

Pentru o listă a transductoarelor compatibile cu sistemul dvs., consultați *Manualul pentru utilizator* și *Actualizarea informațiilor pentru utilizator*, dacă este cazul.

Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului

Transductoarele (numele sistemelor) acoperite de coloana Compatibilitate 1

3D6-2	L12-5 50 mm
3D8-4	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) ²
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	L17-5
7,5 MHz Endo	S3-1
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	S4-1 (iU22)
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	S4-2
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)
C6-3	S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)
C8-4v ¹	S5-2
C8-5	S8
C8-5 Compact (CX30, CX50)	S8-3
C9-4	S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)
C9-4ec	S12
C9-5ec	S12-4
L8-4	S12-4 Compact (CX50)
L9-3	V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)
L11-3	V8-4
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	VL13-5
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	X3-1

L12-5 38 mm	X5-1 (iE33)
L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq)	X7-2 (iE33, iU22)
Transductoarele (numele sistemelor) acoperite de coloana Compatibilitate 2	
3D9-3v (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ)	L15-7io (5000 Compact, Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)
BP10-5ec	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) ²
C5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ, Sparq)	L18-5
C5-2 (ClearVue)	mC7-2
C6-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)	mC12-3
C8-4v ¹	mL26-8
C8-5 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	S4-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)
C9-2	S5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)
C9-3v	S8-3 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)
C9-4v	S9-2
C9-4v Compact	S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)
C10-3v	V6-2 (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)
C10-4ec	V9-2
eL18-4	VL13-5 Compact
eL18-4 EMT	X5-1 (Affiniti, EPIQ)
L12-3 (5000 Compact, Affiniti, CX50, EPIQ)	X5-1c
L12-3ERGO	X6-1
L12-4 (ClearVue)	X7-2 (EPIQ)
L12-4 Compact (5000 Compact, Affiniti)	XL14-3

L12-5 50 mm Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)

Transductoare acoperite de coloana Compatibilitate 3

Creion CW 1,9MHz

TCD 1,9MHz

Creion CW 5,0MHz

D2cwc

D2tcd

D5cwc

TCD

Transductoare acoperite de coloana Compatibilitate 4

S7-3t

S8-3t

Transductoare acoperite de coloana Compatibilitate 5

OMNI III TEE

S6-2mpt

S7-2t

X7-2t

X8-2t

Transductoare acoperite de coloana Compatibilitate 6

L10-4lap

Transductoare acoperite de coloana Compatibilitate 7

C9-3io

Transductoare acoperite de coloana Compatibilitate 8

C5-2 (Lumify, Xperius)

L12-4 (Lumify, Xperius)

S4-1 (Lumify)

Note de subsol

1 Utilizați coloana de Compatibilitate 2 pentru modelele C8-4v cu următoarele coduri pentru componente:

- Cod componentă 45356117292x, unde x este 3 sau mai mare
- Cod componentă 45356128750x, unde x este 2 sau mai mare
- Cod componentă 45356131895x, unde x este 1 sau mai mare
- Cod componentă 45356149748x, unde x este 1 sau mai mare
- Cod componentă 45356149749x, unde x este 1 sau mai mare
- Cod componentă 45356168452x, unde x este 1 sau mai mare

Utilizați coloana de Compatibilitate 1 pentru modelele C8-4v cu alte coduri pentru componente.

Pentru a identifica codul pentru componentă, trebuie să vă uitați în interiorul carcasei conectorului.

2 Utilizați coloana de Compatibilitate 2 pentru modelele L15-7io cu următoarele coduri pentru componente:

- Cod componentă 45356140781x, unde x este 1 sau mai mare
- Cod componentă 45356141827x, unde x este 1 sau mai mare

Utilizați coloana de Compatibilitate 1 pentru modelele L15-7io cu alte coduri pentru componente.

Pentru a identifica codul pentru componentă, trebuie să vă uitați în interiorul carcasei conectorului.

Dezinfectanți și soluții de curățare compatibile

Următorul tabel listează dezinfectanții și soluțiile de curățare compatibili cu transductoarele disponibile pentru sistemele dvs. cu ultrasunete Philips. Utilizați tabelele din „[Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului](#)” de la pagina 33 sau „[Compatibilitatea dezinfectantului în funcție de numele transductorului](#)” de la pagina 28 pentru a identifica transductorul și coloana Compatibilitate corespunzătoare.



ATENȚIE

Utilizarea pe transductoare a alcoolului izopropilic (alcool medicinal), a alcoolului etilic denaturat și a altor produse pe bază de alcool este limitată. În cazul transductoarelor cu conector USB, singurele părți ce pot fi șterse cu alcool sunt: carcasa și lentilele transductorului (fereastra acustică). În cazul transductoarelor non-TEE, singurele părți ce pot fi șterse cu alcool sunt: carcasa conectorului și carcasa și lentilele transductorului. În cazul transductoarelor TEE, singurele părți ce pot fi șterse cu alcool sunt carcasa conectorului și carcasa de comandă. Asigurați-vă că soluția este de 91% alcool izopropilic sau mai slabă sau de 85% de alcool etilic denaturat sau mai slabă. Nu ștergeți nicio altă parte a unui transductor cu alcool (inclusiv cablurile, conectorii USB sau manșoanele de detensionare), deoarece componentele respective ale transductorului se pot deteriora. Aceste deteriorări nu sunt acoperite de garanție sau de contractul dvs. de service.

Pe baza testării compatibilității materialelor, a profilului de utilizare a produselor și a componentelor active, Philips a aprobat în general următoarele tipuri de dezinfectanți de *nivel redus* și *nivel intermediu* utilizate prin pulverizare sau ștergere pe suprafețe (în cazul contactului cu tegumentele) și pentru transductoarele transvaginale și transrectale, conform restricțiilor de compatibilitate din tabelul cu dezinfectanți.



ATENȚIE

Philips nu a emis o aprobare generală pentru utilizarea următoarelor pe transductoarele transesofagiene sau laparoscopice.


- Produse pe bază de hipoclorit de sodiu (de exemplu soluție 10% de înălbitor de uz casnic cu hipoclorit de sodiu activ la aproximativ 0,6%)
- Produse pe bază de amoniu cuaternar (de exemplu, produse care conțin soluție de clorură de amoniu n-alchil xbenzil, unde x poate fi orice grupare funcțională organică precum etil, metil și aşa mai departe; concentrația de utilizare trebuie să fie mai mică de 0,8% din total pentru toate substanțele cu amoniu cuaternar listate)
- Pe bază de peroxid de hidrogen accelerat (maximum 0,5% peroxid de hidrogen)
- Produse pe bază de alcool sau alcool plus amoniu cuaternar (conținutul de alcool nu poate depăși 91% alcool izopropilic sau 85% alcool etilic denaturat)
- Produse nemenționate în mod specific în tabelul de compatibilitate, dar care conțin componente active similare ca cele indicate în această listă și comercializate în scop medical

Atunci când utilizați soluții de curățare și dezinfectante, urmați întotdeauna cu strictețe instrucțiunile producătorului.

Datorită numărului mare de produse de curățare și dezinfectare disponibile, este imposibil să alcătuim o listă cvasi-completă. Dacă nu sunteți sigur de posibilitatea utilizării unui anumit produs, contactați reprezentanța locală Philips pentru asistență.

Legenda tabelului dezinfectanților și soluțiilor de curățare


Țara sau regiunea de origine	Tip de dezinfecțant	Compatibilitate
AU = Australia	CL = Agent de curățare	C = Aprobat pentru utilizare pe cabluri și conector (nu scufundați și nu udați niciodată un conector); excepțiile ce nu au fost aprobată pentru conector sunt notate
CA = Canada	HLD = Dezinfecțant de nivel înalt	
DE = Germania	ILD = Dezinfecțant de nivel mediu	
ES = Spania	LLD = Dezinfecțant de bază	H = Aprobat pentru utilizare pe mâner și pe carcasa mânerului
EU = Europa	S = Sterilizant	N = Nu este aprobat pentru utilizare
FR = Franța		T = Aprobat pentru utilizare pe transductor
JP = Japonia		
UK = Marea Britanie		
US = Statele Unite ale Americii		

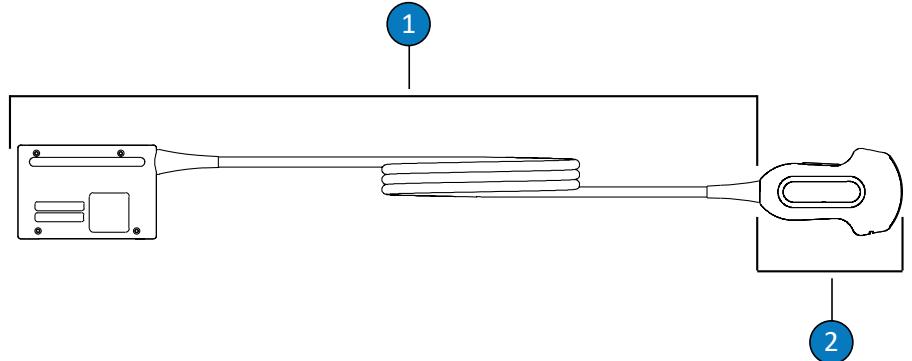

Componente transductor non-TEE


1 C (cablu și conector)

2 T (transductor)

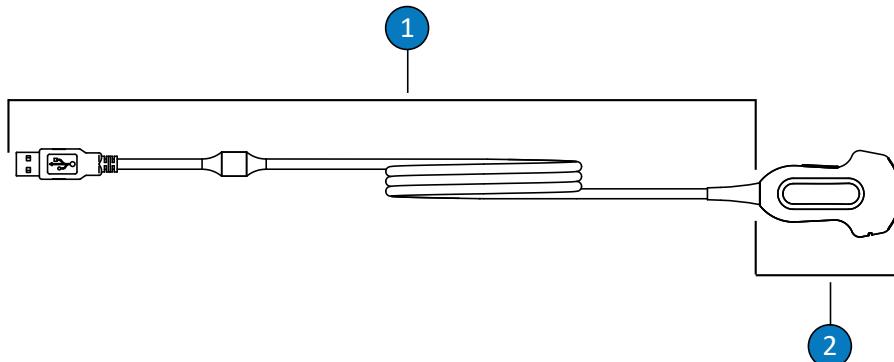

Transductoarele non-TEE (conexiune la USB)

-
- 1 C (cablu și conector)
 - 2 T (transductor)
-

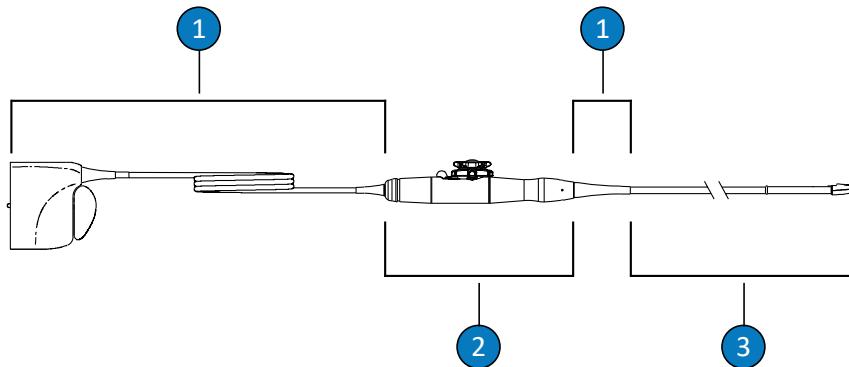

Componente transductor TEE

-
- 1 C (Cablu, conector și manșoane de detensionare)
 - 2 H (Mâner și mecanism de direcționare)
 - 3 T (transductor și fibroscop)
-



ATENȚIE

Utilizarea capacului de protecție pentru pinii conectorului pentru transductoarele TEE în timpul proceselor de decontaminare este obligatorie. Pentru a utiliza transductorul pentru scanare, îndepărtați capacul de pe conector. Păstrați întotdeauna capacul prin cablul transductorului cu cureaua.

OBSERVAȚIE

Utilizați tabelele din „Transductoarele listate în funcție de compatibilitatea dezinfectantului” de la pagina 33 sau „Compatibilitatea dezinfectantului în funcție de numele transductorului” de la pagina 28 pentru a identifica transductorul și coloana Compatibilitate corespunzătoare.

Compatibilitatea dezinfectanților și soluțiilor de curățare

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecție	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Accel Wipes (toate tipurile)	CA	Ștergere	Peroxid de hidrogen	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Acecidé-C (fost Acecidé)	JP	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD, S	N	N	N	N	T	N	N	N
Advantage Plus (rețineți că trebuie să folosiți kitul optional de susținere a sondelor pentru TEE/TOE)	US	AR	Acid peracetic	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Advantage Plus (rețineți că trebuie să folosiți kitul opțional de sușinere pentru sonda ecografică)	US	AR	Acid peracetic	HLD	N	T ⁶ ,C ⁸	N	N	N	N	T ⁶ ,C ⁸	N
Aidal Plus	AU	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Anios Clean Excel D	FR	Pulverizare/ștergere/înmuiere ¹	QUAT, gluconat de clorhexidină, surfactant	CL	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Aniosept Activ	FR	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD, S	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
ANIOXY DM	FR	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD, S	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Anoxyde 1000	FR	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Antigermix E1	FR	Sistem E1	UV-C	HLD	N	N	N	T,C,H ⁵	T,C,H ⁵	N	N	N
Antigermix S1	FR	Sistem S1	UV-C	HLD	T, C ^{2,8}	T, C ^{2,8}	N	N	N	N	T,C ⁸	T,C
Aquacide	US	Ethos Reprocessor	Acid peracetic	Agent de curățare, HLD	N	T,C ^{10,11}	N	N	N	N	T,C	T,C
ASTRA TEE	US	AR	Dependent de soluție	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
ASTRA TEE Ultra	US	AR	Dependent de soluție	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecțant	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
ASTRA VR	US	AR	Dependent de soluție	HLD	T ⁹	T ⁹	N	N	N	N	N	N
ASTRA VR Ultra	US	AR	Dependent de soluție	HLD	T ⁹	T ⁹	N	N	N	N	N	N
Bacillol 30 Foam	DE	Pulverizare/ ștergere	Alcool, Alchilamină	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Banicide Plus	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Înălbitor (max 0,6% NaOCl)	Toate	Pulverizare/ ștergere	Hipoclorit de sodiu	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
CaviWipes	US	Ștergere	Alcool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Cidalkin (fost Alkaspray)	FR	Pulverizare/ ștergere	Alcool, Alchilamină	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Cidex OPA	US	Înmuiere ¹	Orto-ftalaldehidă	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Cleanisept Wipes	DE	Pulverizare/ ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Clinell Sporicidal Wipes	UK	Ștergere	Acid peracetic, surfactant	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Clinell Universal Wipes	UK	Pulverizare/ ștergere	QUAT, Biguanidă	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Clorox Healthcare Bleach Germicidal Cleaner	US	Pulverizare/ștergere	Hipoclorit de sodiu	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Dezinfectanți Clorox Healthcare Hydrogen Peroxide Cleaner	US	Pulverizare/ștergere	Peroxid de hidrogen	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Combi-Instruments-N	DE	Înmuiere ¹	Amestec glutaraldehidă și formacetale	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Alcool etilic denaturat (maximum 85%)	Toate	Pulverizare/ștergere	Alcool etilic denaturat, apă	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Desconton Extra	DE	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Dispatch	US	Pulverizare/ștergere	Hipoclorit de sodiu	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
DSD 201 (rețineți că trebuie să folosiți kitul optional Bridge)	US	AR	Dependent de soluție	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
DSD EDGE (rețineți că trebuie să folosiți kitul optional Bridge)	US	AR	Acid peracetic	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
Endozime Enzymatic (toate tipurile)	US	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Enzol	US	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Epizyme Rapid	AU	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Gigasept FF (nou)	DE	Înmuiere ¹	Dialdehidă succinică	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	N	T,C ⁸	T
Gigasept PAA	DE	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Gigasept PAA Concentrat	DE	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Hexanios G+R	FR	Înmuiere ¹	QUAT, biguanidă, surfactant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	T

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfec- tant	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Hibiclens (4% Max)	US	Precurățare	Gluconat de clorhexidină	CL	T,C	T,C	T	N	N	T,C	T,C	T,C
Hypernova Chronos	FR	Chronos System	UV-C	HLD	T,C 2,8	T,C ^{2,8}	N	N	N	N	T,C ⁸	T,C
Incidin	DE	Pulverizare/ ștergere	Alcool	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Incidin OxyWipe	DE	Pulverizare/ ștergere	Peroxid de hidrogen, Surfactant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyWipe S	DE	Pulverizare/ ștergere	Peroxid de hidrogen, Surfactant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyFoam	DE	Pulverizare/ ștergere	Peroxid de hidrogen, Surfactant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyFoam S	DE	Pulverizare/ ștergere	Peroxid de hidrogen, Surfactant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin Plus	DE	Înmuiere ¹	Glucoprotamină	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Incidin Rapid	DE	Pulverizare/ ștergere	QUAT, Glutaraldehidă	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Incidur Spray	DE	Pulverizare/ ștergere	Alcool, QUAT, aldehidă	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Instruzyme	FR	Precurățare	Enzime, QUAT, biguanidă	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Intercept Detergent	US	AR	Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Intercept Wipes	US	Ștergere	Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T,C
Alcool izopropilic (maximum 91%)	Toate	Pulverizare/ștergere	Alcool izopropilic, apă	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Klenzyme	US	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Korsolex Basic	FR	Înmuiere ¹	Eliberare de aldehide	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Korsolex Extra	FR	Înmuiere ¹	QUAT, Aldehidă	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Lumicare ONE	AU	AR	UV-C	HLD	T,C ¹¹	T,C ¹¹	N	N	N	N	N	N
Matrix Biofilm Remover	AU	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	T	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
MaxiCide Plus	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MedDis	UK	Înmuiere ¹	QUAT, acid amidosulfonic	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Lavete dezinfectante Medipal	UK	Ștergere	QUAT, Biguanidă	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Medistel	UK	Înmuiere ¹	QUAT, acid amidosulfonic	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Medizyme	AU	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
MetriCide	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MetriCide 28	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MetriCide OPA Plus	US	Înmuiere ¹	Orto-ftalaldehidă	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MetriCide Plus 30	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MetriZyme	US	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Şervețele virucide Mikrobac	DE	Ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Lavete mikrozid PAA	DE	Ștergere	Acid peracetic	LLD, ILD	N	T,C	T,C	N	T,C	T,C,H	T,C	T,C
Soluție slabă de săpun ⁴	Toate	Precurățare	Surfactant	CL	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Milton	AU	Pulverizare/ ștergere	Hipoclorit de sodiu	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
NDP Med Concentrated Plus	ES	Înmuiere ¹	N-Duopropenide, Alkilamină	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
neodisher endo CLEAN/ neodisher endo SEPT PAC	DE	AR	Surfactant, acid peracetic	CL, HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
neodisher endo DIS activ	DE	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
neodisher Septo Active	DE	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Omnicide	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Omnicide 28	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
OPAL	AU	Înmuiere ¹	Orto-ftalaldehidă	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Opti-Cide3	US	Pulverizare/ ștergere	Alcool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Oxivir (toate tipurile)	US	Ștergere	Peroxid de hidrogen	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Oxygenon-I	DE	Înmuiere ¹	Generare de oxigen	HLD	N	T,C ⁸	N	T ³	T	T	T,C ⁸	T
Perastel	UK	AR/Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
PerCept (toate tipurile)	CA	Ștergere	Peroxid de hidrogen	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Phagocide D	FR	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
PI-Spray (fost T-Spray)	US	Pulverizare/ ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PI-Spray II (fost T-Spray II)	US	Pulverizare/ ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PREempt Concentrat	CA	Pulverizare/ ștergere	Peroxid de hidrogen	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PREempt RTU	CA	Pulverizare/ ștergere	Peroxid de hidrogen	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Lavete PREempt	CA	Ștergere	Peroxid de hidrogen	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
ProCide-D	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
ProCide-D Plus	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Prolystica 2X	US	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Dezinfectant Protex (toate tipurile)	US	Pulverizare/ ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Proxy P/ Proxy A	AU	AR	Acid peracetic	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Amoniu cuaternar (maximum 0,8% activ)	Toate	Pulverizare/ ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
RAPICIDE Glut	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
RAPICIDE OPA/28	US	Înmuiere ¹	Orto-ftalaldehidă	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
RAPICIDE PA	US	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	N
RAPICIDE PA Single Shot	US	AR	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	N
Rely+On PeraSafe (fost PeraSafe)	UK	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD, S	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Revital -Ox Enzymatic (toate tipurile)	US	Înmuiere ¹	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Revital-Ox RESET	US	Înmuiere ¹	Peroxid de hidrogen	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T ³	T	T	N	T
Rivascop	FR	Pulverizare/ ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Salvanios pH 10	FR	Pulverizare/ ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-24	US	Pulverizare/ ștergere	Alcool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth Active	DE	Ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF	US	Ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF3	US	Ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Sani-Cloth Bleach	US	Ștergere	Hipoclorit de sodiu	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Sani-Cloth CHG 2%	UK	Pulverizare/ ștergere	Alcool, gluconat de clorhexidină	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth HB	US	Ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Plus	US	Ștergere	Alcool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth Prime	US	Ștergere	Alcool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sekucid N	FR	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Aktiv	DE	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Easy	DE	Înmuiere ¹	Acid peracetic	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Plus	DE	Înmuiere ¹	Glucoprotamină	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Serie TEE	FR	AR	Dependent de soluție	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
Soluscope P/ Soluscope A	FR	AR	Acid peracetic	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Sono Ultrasound Wipes	US	Ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C	T,C
Steranios 2%	FR	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
STERRAD 100S	US	AR	Peroxid de hidrogen	S	N	N	N	N	N	T ⁶ ,C, H	N	N

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Super Sani-Cloth	US	Ștergere	Alcool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
TD-5	US	Reprocesor TD-100, Reprocesor TEEClean	Glutaraldehidă	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-8	US	Reprocesor TD-100, Reprocesor TEEClean	Orto-ftalaldehidă	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-12	US	Reprocesor TD-200	Acid peracetic	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TEEZyme	US	Reprocesor TEEClean	Enzime, Surfactant	CL	N	N	N	T	T	N	N	N
TEEZymeMC	US	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
TEEZyme Sponge	US	Precurățare	Enzime, Surfactant	CL	N	N	N	T	T	N	N	N
Tristel DUO	UK	Spumă/ șervețele	Dioxid de clor	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	N	N	N	T,C	T,C
Tristel DUO ULT	UK	Spumă/ șervețele	Dioxid de clor	HLD	T,C	T,C	T,C	N	N	N	T,C	T,C
Tristel ULT	UK	Spumă/ șervețele	Dioxid de clor	HLD	T,C	T,C	T,C	N	N	N	T,C	T,C

3000 131 85551_A/795 * MAR. 2024

Philips

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Tristel Fuse for Stella	UK	Sistem Stella	Dioxid de clor	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Tristel Sporicidal Wipes	UK	Ștergere	Dioxid de clor	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Sistemul Tristel Trio Wipes	UK	Şervețel pre-curățare, șervețel sporicid, șervețel clătire	Enzime, surfactant, dioxid de clor	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T
trophon2	AU	Reprocesor trophon2	Peroxid de hidrogen	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	T,C
Lavete de curățare trophon Companion	AU	Ștergere	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
UltrOx	US	Înmuiere ¹	Peroxid de hidrogen	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T ³	T	T	N	T
trophon EPR	AU	Reprocesor trophon EPR	Peroxid de hidrogen	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	N
Vaposeptol	FR	Pulverizare/ ștergere	Alcool, Biguanidă	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Virox 5 RTU	CA	Ștergere	Peroxid de hidrogen	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wavicide -01	US	Înmuiere ¹	Glutaraldehidă	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

Soluție/ Sistem	Țara sau regiunea de origine	Uz aprobat	Substanță activă	Tip de dezinfecția	Coloanele Compatibilitate							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Wip'Anios Excel	FR	Ștergere	QUAT, biguanidă, surfactant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wip'Anios Premium	FR	Ștergere	QUAT, biguanidă, surfactant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

1. Nu scufundați și nu udați niciodată un conector. Aceste produse pot fi utilizate în reprocesoare automate pentru endoscoape (AR), în conformitate cu procedurile descrise în documentul *Îngrijirea și curățarea sistemelor cu ultrasunete și a transductoarelor*.
2. Antigermix S1 și Hypernova Chronos nu sunt aprobată pentru 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2, VL13-5 sau VL13-5 Compact.
3. Oxygenon-I și Revital-Ox RESET pot produce o ușoară modificare a culorii la fibroscopul transductoarelor S7-3t și S8-3t. Această modificare a culorii nu are niciun efect asupra siguranței sau performanțelor dispozitivului.
4. Soluțiile slabe de săpun nu conțin ingrediente dure și nu sunt iritante pentru piele. Acestea nu trebuie să conțină parfumuri, uleiuri sau alcool. Dezinfectanții pentru mâini nu sunt aprobați pentru utilizare.
5. Antigermix E1 poate decolora componente din plastic ale transductoarelor transesofagiene.
6. Pentru soluțiile specifice utilizate cu acest reprocesor automat, consultați „[Îndrumări pentru AR \(Reprocesoare automate\)](#)” de la pagina 20.
7. Pentru soluțiile specifice utilizate cu acest dispozitiv de dezinfecție automat, consultați „[Îndrumări pentru Dezinfecție pentru transductoarele TEE și Dezinfecție și curățătoare automate](#)” de la pagina 24.
8. Aprobăt numai pentru cabluri; nu este aprobat pentru conectare.
9. Pentru soluțiile specifice utilizate cu acest reprocesor automat (numai pentru transductoarele transvaginale și transrectale), consultați „[Îndrumări pentru AR \(Reprocesoare automate\)](#)” de la pagina 20.

10. Sistemul ETHOS, atunci când este utilizat conform instrucțiunilor de pe etichetă, nu expune conectorul traductorului la substanțele chimice de curățare și dezinfectare.
11. Acest sistem nu este aprobat pentru V6-2, V8-4 sau VL13-5, din cauza limitelor geometrice.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea sau transmiterea integrală sau parțială, sub orice formă sau prin orice metodă, electronică, mecanică sau alta, fără aprobarea prealabilă în scris a deținătorului dreptului de autor.

Publicat în SUA
3000 131 85551_A/795 * MAR. 2024 - ro-RO